

kat. č. 25.07

Nábytek pro čisté prostory v provedení GMP

PITEVNÝ STÔL: ZÁKAZKOVÁ VÝROBA



Pitevný stôl, vyrábaný z vysoko odolnej nereze, ktorý spĺňa podmienky a využiteľnosť náročných laboratórnych ako aj potrebných úrovni čistých priestorov, kde veľký dôraz je prikladaný na dlhotrvácnosť - ľahkú čistiteľnosť a funkčnosť. Tento stôl je možné variovať podľa požiadaviek zákazníka s optimalizáciou a zameraním sa na anatomickú disekciu malých živočíchov. Konštrukčné riešenia sú konzultované a zapracované v návrhoch a vyrobené, aby požiadavky zákazníka spĺňali prísne požiadavky na sterilitu a odolnosť.

Pracovný stôl je zostavený:

- **Nerezovej podnože**
- **Pracovnej dosky - Integrovaný drenážny systém:** Pracovná plocha je tvarovaná s miernym sklonom smerom k integrovanej drenážnej vani a odtokovému otvoru. Tento systém zabezpečuje efektívne odvádzanie tekutín a minimalizuje akumuláciu biologického materiálu na povrchu.
- **Možnosť voliteľného systému odvodu tekutín - biologického odpadu**
- **Možnosť odpadovej integrovanej nádoby pod drenáž**
- **Vysoko Odolné Kolieska:** Stôl je osadený štyrmi robustnými kolieskami s priemerom optimalizovaným pre ľahký pohyb aj na nerovnom povrchu. Každé koliesko je vybavené nezávislou brzdou (stop lock), ktorá zabezpečuje absolútnu stabilitu stola počas pitvy a zabraňuje nežiaducemu pohybu.
- **Ergonomické Rozmery:** podľa požiadaviek klienta (všetky návrhy sú optimalizované v závislosti k požiadavkám klienta). Tieto proporcie sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálny dosah a minimalizovali únavu operátora počas dlhších procedúr.

Rozmerová rada: (príklady min. a max. rozmerových rád)

Šírka stola - A (mm) 900; 1200; 1600; 1800

Hĺbka stola - B (mm) 600; 800; 900


Výška stola - C (mm) 750, 900

- **Nosnosť a aplikácia:** požiadavky pre bezpečnú manipuláciu s exemplármi v hmotnosti **80 - 100 kg**. Ideálna platforma pre veterinárnu patológiu, anatomické štúdie a výskumné disekcie malých živočíchov. Nosnosť je v prípade potreby optimalizovaná cez konštrukčný návrh podľa požiadaviek všetkých požadovaných parametrov zákazníka.


Materialové prevedenie:

- Konštrukcia a pracovná plocha sú kompletne zhotovené z **austenitickej nerezovej ocele triedy AISI 304**. Tento materiál je vybraný pre svoju vynikajúcu odolnosť voči chemickým činidlám, biologickým kontaminantom a korózii, čo je kľúčové pre prostredie s častou dezinfekciou.

Základná zostava:

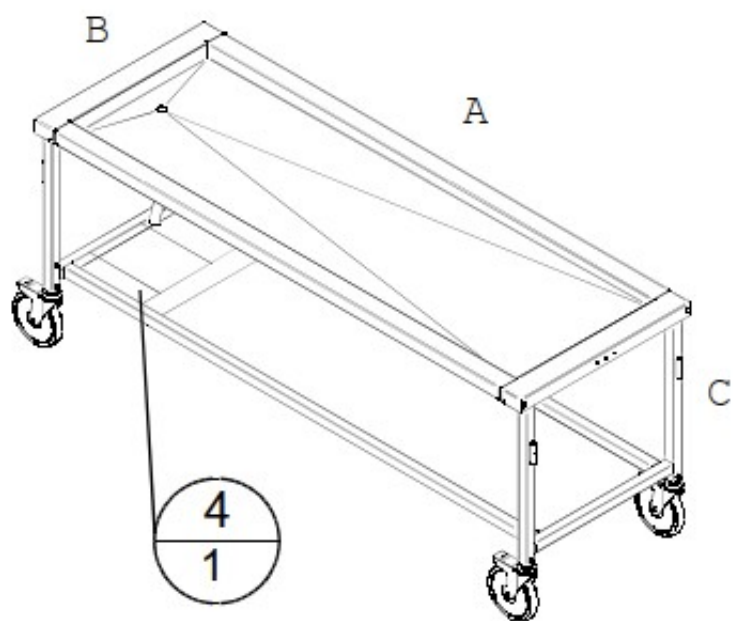

Item Number	Quantity	Title
1	1	NON-ELEVATING CART FRAME ASSEMBLY
2	4	CASTER - 8" TL (POWDER COATED) RED
3	1	DRAIN TUBE PVC TUBING, 1" I.D. x 1-1/4" O.D.
4	1	BLOOD CONTAINER

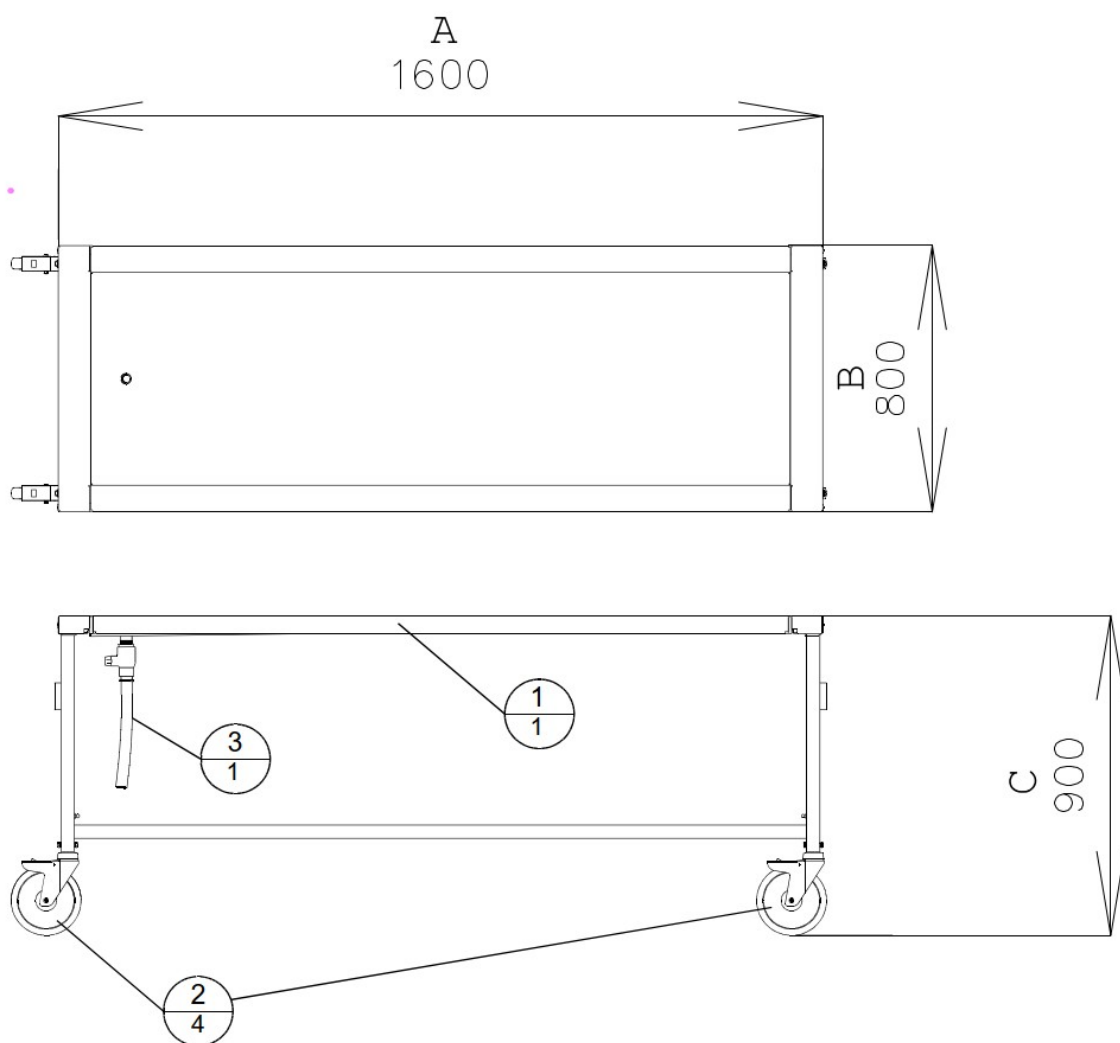

Item Number	Quantity	Title
1	1	NON-ELEVATING CART FRAME ASSEMBLY
2	4	CASTER - 8" TL (POWDER COATED) RED
3	1	DRAIN TUBE PVC TUBING, 1" I.D. x 1-1/4" O.D.
4	1	BLOOD CONTAINER

TECHNICKÁ DATA

Označenie zákazkového výrobku	
Pitevný laboratórny stôl	
Výrobok je navrhovaný a konštrukčne optimalizovaný podľa parametrov zákazníka a je vyrábaný na zákazku. Výrobok na mieru zákazníka s podporou a zapracovaním konštrukčnej výrobitel'nosti so zapracovaním požiadaviek GMP a potrieb klienta na mieru.	
Šírka A	
šírka	hodnota
900 mm	Šírka stolu
1200 mm	Šírka stolu
1600 mm	Šírka stolu
1800 mm	Šírka stolu
mm mm	Šírka stolu
Hĺbka B	
Hĺbka stola	
Hĺbka stola	
Hĺbka stola	
Hĺbka stola	
Výška C	
Výška stolu	
Výška stolu	
Výška stolu	
Uvedená výška stolu je celková výška vrátane pojazdných koliesok a vrchnej hrany dosky.	
Materiálové prevedenie	
Materiálové prevedenie stola	
Materiálové prevedenie stola	
Materiálové prevedenie stola	
Materiálové prevedenie kostry stola	
Povrch kostry stola	
Nosnosť stola	
Nosnosť stola	
Nosnosť stola	
Nosnosť stola	
Kolieska s funkciou Stop-lock	
Kolieska s funkciou Stop-lock	
Kolieska s funkciou Stop-lock	
Klieská zabezpečujúce mobilitu stola s funkciou stop-lock (v kombinácii 2ks s funkciou stop-lock - brzdenia, alebo všetkých štyroch kolies)	
Integrovanej nádoba pod drenáž	
S integrovanou nádobou	
BEZ integrovanou nádobou	
Doplnenie referencie - S integrovanou nádobou	
Voliteľný variant - potrebné zadať zákazníkovi podľa požiadaviek a funkcionality.	

Odtokový systém - drenáž

Odtokový systém - drenáž

Potrebné zadefinovať odtokový systém z hľadiska funkcionality a užívateľských preferencií pri práci.

Doplňujúce parametre - preferencie

Q-parametre/preferencie

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

